
GUÍA RÁPIDA DE USO

HI739

Fluoruro Rango Alto

CONSEJOS PARA UNA MEDICIÓN CORRECTA

- Es importante que la muestra no contenga precipitados.
- Siempre que se coloque la cubeta en la celda de medición, debe estar seca por fuera y completamente libre de huellas dactilares, aceite y suciedad. Límpielo a fondo con HI731318 o un paño sin pelusa antes de la inserción.
- Agitar la cubeta puede generar burbujas y provocar lecturas más altas. Para obtener mediciones correctas, elimine dichas burbujas girando o golpeando suavemente la cubeta.
- No deje reposar la muestra reaccionada por mucho tiempo después de agregar el reactivo, ya que la medición se verá afectada.
- Después de la lectura, es importante desechar inmediatamente la muestra, de lo contrario el vidrio podría mancharse permanentemente.

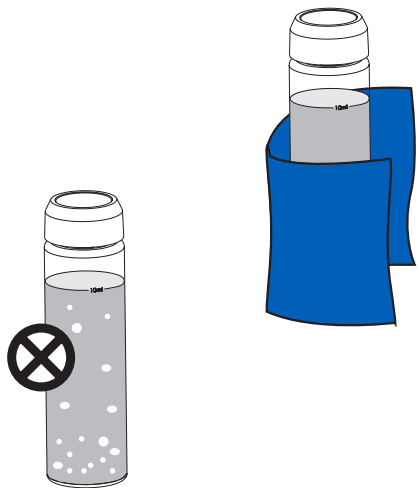

HANNA® instruments

REALIZAR MEDICIONES

- Encienda el medidor presionando el botón. Se mostrarán todos los segmentos. Cuando la pantalla muestra "**Add**"(agregar), "**C.1**" con "**Press**" (presionar) parpadeando, el medidor está listo.
- Utilizando la jeringa suministrada, agregue 2 ml (1 ml dos veces) del reactivo HI739AS a la cubeta y use la pipeta para llenar la cubeta hasta la marca con el reactivo HI739BS.
- Vuelva a colocar la tapa y agite suavemente para mezclar.
- Coloque la cubeta en el medidor y cierre la tapa.
- Mantenga presionado el botón hasta que aparezca el temporizador en la pantalla LCD (la pantalla mostrará la cuenta atrás antes de la medición) o, alternativamente, espere 1 minuto y luego presione el botón. Cuando la pantalla muestra "**Add**", "**C.2**" con "**Press**" parpadeando el medidor está puesto a cero.
- Retire la cubeta del medidor y desenrosque la tapa. Usando la jeringa no utilizada, agregue exactamente 1 ml de muestra.
- Vuelva a colocar la tapa y agite suavemente para mezclar.
- Vuelva a colocar la cubeta en el medidor.
- Mantenga presionado el botón hasta que aparezca el temporizador en la pantalla LCD (la pantalla mostrará la cuenta atrás antes de la medición) o, alternativamente, espere 1 minuto y luego presione el botón.

Nota: Para ver los mensajes de error y el reemplazo de la batería, consulte el manual.

